



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No.
SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019
RELATIVA A LA ADQUISICIÓN, DESINSTALACIÓN, E INSTALACIÓN
DE BÁSCULAS CAMIONERAS ELECTRÓNICAS DE BAJO PERFIL**

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las **11:00-once horas del día 27-veintisiete de Agosto de 2019-dos mil diecinueve** día y momento señalado en la Convocatoria que contiene las bases de la Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019, formulada para la contratación de la Adquisición de Básculas Camioneras Electrónicas de Bajo Perfil, encontrándose reunidos en las oficinas de este Organismo Público Descentralizado denominado Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos, en lo sucesivo de ésta acta, “**SIMEPRODE**”, ubicado en la calle Emilio Carranza número 730 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo León; Los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, en concordancia con los Artículos 13 y 15 del Reglamento de la Ley antes citada; C.P. HERIBERTO JESÚS RAMÍREZ MELO, Representante de SIMEPRODE; LIC. IRLANDA GARCÍA ESPARZA, Representante Suplente del Responsable del Área Jurídica de SIMEPRODE; Se hace constar que no se encuentra presente la C. Representante Suplente de la Secretaría de Administración aún y cuando fue convocada mediante oficio en tiempo y forma; LA C.P. ERIKA YADIRA GONZÁLEZ GÓMEZ, Representante Suplente de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; ING. CLAUDIO ALEJANDRO BANDA TREVIÑO, como Titular del Área Requirente y Jefe de Básculas de SIMEPRODE y como Invitado el C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES, Contralor Interno de SIMEPRODE, se reunieron a fin de celebrar la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019, formulada para la Adquisición, Desinstalación e Instalación de Básculas Camioneras Electrónicas de Bajo Perfil, conforme lo dispuesto por los artículos 34 y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, 72, 73 y demás relativos de su Reglamento y el numeral 5 de la Bases de la citada Licitación Pública Nacional Presencial.

En uso de la palabra y quien preside el presente Acto C.P. HERIBERTO JESUS RAMÍREZ MELO, procede a tomar lista de asistencia, firmando para constancia las personas reunidas en éste acto y agregándose a la presente acta la lista de asistencia mencionada, la cual forma parte integrante de la misma; se declara la existencia legal de quórum para la celebración de ésta Acta de Sesión Extraordinaria de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 18 de la Ley de Adquisiciones,

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León y artículo 15 fracción I de su Reglamento; por lo cual los acuerdos que se tomen durante esta Asamblea, serán plenamente válidos y surtirán los efectos legales a que haya lugar.

Por lo que se procede a dar inicio a la Sesión de Junta de Aclaraciones, no sin antes y en cumplimiento a la normatividad establecida en el artículo 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y encontrándose presente los participantes: **FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN S.A. DE C.V.**, y **LEDPA, S.A. DE C.V.** se solicita su autorización para ser filmado durante el presente evento de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPMP-004-2019 y para su difusión en las redes oficiales de la Unidad Convocante; a lo que manifiestan que si otorgan su autorización para los fines antes mencionados.

Acto continuo se hacen constar que en relación de las preguntas realizadas por el Participante **LEDPA, S.A. DE C.V.** dentro del presente evento de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPMP-004-2019, realizadas a través de correo electrónico en fecha 25 de agosto de 2019, se adjunta copia de dicho correo.

Acto continuo se señalan las preguntas realizadas por el licitante “**LEDPA, S.A. DE C.V.**”

PREGUNTA No. 1.- Al no tener acceso a revisar las obras civiles existentes ya que se encuentran basculas instaladas actualmente y dichas obras presenten alguna falla estructural, la unidad convocante se hará cargo de las reparaciones?

RESPUESTA: Si, SIMEPRODE se hace responsable por la obra civil existente.


PREGUNTAS SOBRE FICHA TECNICA

PREGUNTA No. 2.- En las instalaciones de Santa Catarina hay semáforos operando y no vienen nombrados en la propuesta estos semáforos se operan por medio del software o por el indicador?

RESPUESTA: Por ninguno de los dos, lo opera manualmente El o La Basculista.

PUNTO 5 DE LA FICHA TÉCNICA. LA INTERFACE DIGITAL DE PESO

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



PREGUNTA No. 3.- Cuál es la finalidad de los 6 canales Digitales I/O cada uno configurable como entrada y salida?

RESPUESTA: La finalidad es controlar dispositivos adicionales, semáforos, plumas.

PREGUNTA No. 4.- ¿Cuál es el objetivo USB hacia la computadora?

RESPUESTA: Se utilizará como medio alternativo para la conexión a la computadora cuando por algún motivo la LAN este fuera de servicio.

PREGUNTA No. 5.- Si es para la comunicación pudiera usarse RS232?

RESPUESTA: No, favor de apegarse a la Ficha Técnica.

PREGUNTA No. 6.- Cuál es la finalidad el BUS para conexiones de PLC y dispositivos transductores Ethernet?

RESPUESTA: La finalidad es conectar tarjetas para que la conexión al indicador sea a través de una red TCP/IP.

PREGUNTA No. 7.- A qué se refiere con controlado por comandos de software desde el puerto Serial ?

RESPUESTA: El programa de básculas interactúa con el Indicador enviándole comandos para realizar distintas funciones como detener/iniciar el flujo de datos, el reset a Zero del peso etc.

PREGUNTA No. -8 ¿A qué se refiere con Mapeo de Funciones desde puerto digitales de entrada?

RESPUESTA: Los dispositivos conectados al indicador por medio de los puertos digitales ya sea integrados o en las tarjetas de expansión se pueden controlar por algunos de los botones que tiene el Indicador permitiéndole al usuario controlarlos directamente en el indicador.

PREGUNTA No.-9 ¿Cuál es la finalidad del Bus de expansión para tarjetas opcionales?

RESPUESTA: Tener capacidad para conectar otros dispositivos como lectores RFID.

[Handwritten signatures and initials on the right margin]



SIMEPRODE
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

“2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES”

ESTO ES
Una buena cosecha

PREGUNTA No. 10.- Con respecto al programa de trabajo, se podrá dar una prórroga ya que hay que considerar la reingeniería y planos para adecuarnos a las obras civiles existentes, además del tiempo de fraguado correcto del concreto?

RESPUESTA: No, favor de apegarse a lo establecido en la Ficha Técnica y las presentes Bases.

Acto continuo se hace constar que ya no hubo preguntas por parte de los participantes, y conforme a la fracción XXIII del artículo 31 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, suscribieron la presente acta las personas que en calidad de observador estuvieron presentes en la misma.

Se les informa a los participantes lo siguiente:

1.- Deberán presentar el día **04-cuatro de septiembre de 2019 a las 11:00- once horas**, en la oficina de la Unidad Convocante ubicada en Emilio Carranza Número 730 Sur, Centro de Monterrey, Nuevo León (sótano), sus Propuestas Técnicas y sus Propuestas Económicas, en un sobre cerrado, solicitadas en la Convocatoria que contiene las Bases de la Licitación, siguiéndose el procedimiento señalado en el artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluido este Acto de Junta de Aclaraciones, siendo las 12:10- doce horas con diez minutos del día 27-veintisiete de agosto de 2019, la omisión de firma por parte de los licitantes no invalidará el contenido y los efectos del Acta, firmando para constancia y efectos legales que le son inherentes, las personas que intervinieron en este acto, y así quisieron hacerlo, sirviendo la presente Acta de Notificación Legal, entregándose copia de la misma a los presentes.

Comité de Adquisiciones de Sistema Integral para el Manejo Ecológico y
 Procesamiento de Desechos

CON VOZ Y VOTO

C.P. HERIBERTO JESÚS RAMÍREZ MELO
 Representante de SIMEPRODE



LIC. IRLANDA GARCÍA ESPARZA
 Representante Suplente del
 Responsable del Área Jurídica de SIMEPRODE

CON VOZ

MASTER E ING. CLAUDIO
 ALEJANDRO BANDA TREVIÑO
 Jefe de Básculas de SIMEPRODE y
 Titular del Área Requirente

C.P. ERIKA YADIRA GONZALEZ
 GÓMEZ
 Representante de la Contraloría y
 Transparencia Gubernamental. Dejando
 salvaguardadas las facultades de verificación
 de la Contraloría y Transparencia
 Gubernamental.

INVITADO

C.P. FRANCISCO JAVIER MORFIN FLORES
 Contralor Interno de SIMEPRODE

LICITANTES

C. LEONEL SANTOS MANLLO
 REPRESENTANTE LEGAL DE LEPDA, S.A. DE C.V.



SIMEPRODE
Nuevo León
 GOBIERNO DEL ESTADO

"2019, AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES"



ESTO ES
Una buena cosecha

C. VICTOR ALEJANDRO BARRIENTOS REYNA
"FABRICANTES DE EQUIPOS PARA REFRIGERACIÓN"
EN CALIDAD DE OBSERVADOR

C. KARINA YOLANDA CUMPLIDO DAVILA
"LEPDA, S.A. DE C.V."
EN CALIDAD DE OBSERVADOR

La presente hoja forma parte integral del Acta de Junta de Aclaraciones relativa a la Licitación Pública Nacional Presencial No. SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019.

**SISTEMA INTEGRAL PARA EL MANEJO ECOLÓGICO Y PROCESAMIENTO DE
DESECHOS
P R E S E N T E . -**

**“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019
RELATIVA A LA ADQUISICION, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BASCULAS
CAMIONERAS ELECTRONICAS DE BAJO PERFIL”**

CARTA DE INTERÉS EN PARTICIPAR

Por medio de la presente manifestamos BAJO PROTESTA DECIR VERDAD, nuestro **INTERÉS en PARTICIPAR** en la **“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL No. SIMEPRODE-GA-LPNP-004-2019 RELATIVA A LA ADQUISICION, DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE BASCULAS CAMIONERAS ELECTRONICAS DE BAJO PERFIL”**, lo anterior conforme al artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado y 72 de su Reglamento.


NOMBRE DE LA EMPRESA: LEDPA SA DE CV

DOMICILIO DE LA EMPRESA: Ave. Reforma 1414 Col Centro, Monterrey NL CP 64000

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Leonel Santos Manillo

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Leonel Santos Manillo.

Monterrey, Nuevo León a
26 de Agosto del 2019

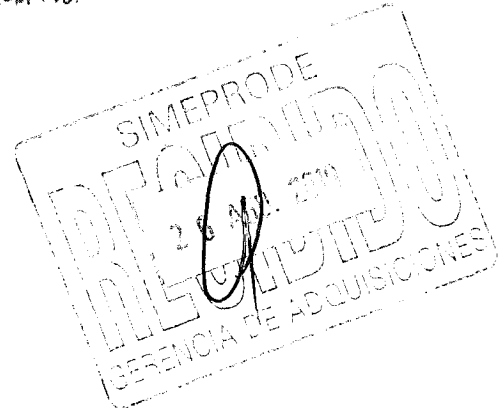

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
LSM

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
40 ef



Patricia Mata Flores

Para:

Heriberto Jesus Ramirez Melo

Asunto:

RE: Preguntas de aclaracion de convocatoria adquisicion, desinstalacion e instalacion de basculas camioneras electronicas de bajo perfil LPNP-003-2019



LSM

De: leonel.santos@bacosa.com.mx [mailto:leonel.santos@bacosa.com.mx]

Enviado el: domingo, 25 de agosto de 2019 04:13 p.m.

Para: Heriberto Jesus Ramirez Melo

Asunto: Preguntas de aclaracion de convocatoria adquisicion, desinstalacion e instalacion de basculas camioneras electronicas de bajo perfil LPNP-003-2019

1.- Al no tener acceso a revisar las obras civiles existentes ya que se encuentran basculas instaladas actualmente y dichas obras presenten alguna falla estructural, la unidad convocante se hará cargo de las reparaciones???

PREGUNTAS SOBRE FICHA TECNICA

1.- En las instalaciones de santa Catarina hay semáforos operando y no vienen nombrados en la propuesta estos semáforos se operan por medio del software o por el indicador?

Punto 5 de la ficha técnica. La interface Digital de Peso

2¿Cuál es la finalidad de los 6 canales Digitales I/O cada uno configurable como entrada y salida?

3¿ Cual es el objetivo USB hacia la computadora?

4 ¿ si es para la comunicación pudiera usarse RS232?

5¿Cuál es la finalidad el BUS para conexiones de PLC y dispositivos transductores Ethernet?


6¿ a que se refiere con controlado por comandos de software desde el puerto Serial .?

7¿A que se refiere con Mapeo de Funciones desde puerto digitales de entrada.?

8 Cual es la finalidad del Bus de expansión para tarjetas opcionales.

9.- Con respecto al programa de trabajo, se podrá dar una prorrogga ya que hay que considerar la reingeniería y planos para adecuarnos a las obras civiles existentes, además del tiempo de fraguado correcto del concreto?





La Bascula Exacta que Necesitas

Karina Cumpido

Cel. 8117640816 Tel: 0181 83317298 / 83511425

WWW.BASCULASMETROLOGY.COM.MX

Básculas y Accesorios de Peso, S.A. de C.V.

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]